


Приложение 15
к Правилам организации
и проведения закупок
лекарственных средств,
медицинских изделий
и специализированных
лечебных продуктов в рамках
гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи,
дополнительного объема
медицинской помощи для лиц,
содержащихся в следственных
изоляторах и учреждениях
уголовно-исполнительной
(пенитенциарной)
системы, за счет бюджетных
средств и (или) в системе
обязательного социального
медицинского страхования,
фармацевтических услуг
Форма

Техническая спецификация ЛОТ №4

№ п/п	Критерии	Описание			
1	Наименование медицинской техники	Установка моечная			
2	Требования к комплектации	№ п/п	Наименование комплектующего к медицинской технике (наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники)	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
		1	Установка моечная	Установка моечная предназначена для автоматической одновременной обработки двух гибких эндоскопов и должна обеспечивать окончательную очистку, дезинфекцию высокого уровня, споласкивание и сушку эндоскопов в одном цикле обработки.	1 шт

			<p>В установке моечной : Наличие промывки поверхности эндоскопов, внутренних каналов и клапанов проточной жидкостью с обработкой ультразвуком.</p> <p>Наличие функции орошения каналов эндоскопов спиртом.</p> <p>Устанавливаемое время промывки эндоскопов в диапазоне не менее 1 минуты не более 10 мин.</p> <p>Устанавливаемое время дезинфекции эндоскопов в диапазоне от 0 до 60 мин.</p> <p>Возможность подогрева жидкости не менее 20С не более 30С.</p> <p>Наличие функции принудительного слива жидкости.</p> <p>Наличие встроенной проверки на герметичность эндоскопов.</p> <p>Наличие функции идентификации эндоскопов.</p> <p>Наличие функции идентификации персонала.</p> <p>Наличие встроенного принтера, выдающего распечатку результатов обработки.</p> <p>Наличие системы фильтрации воды и воздуха.</p> <p>Возможность дезинфекции высокого уровня и стерилизации.</p> <p>Вес машины (без жидкости и эндоскопов) не более 120 кг.</p> <p>Наличие колес для транспортировки.</p> <p>Наличие не более одной моечной ванны для обработки одновременно двух эндоскопов.</p> <p>Емкость моечной ванны не более 12л не меньше 11 л</p> <p>Емкость бака для дезинфектанта не более 17,5л не менее 17 литров.</p> <p>Возможность использования кассетных сосудов с дезинфицирующим раствором для предотвращения контакта персонала с дезинфектантом.</p> <p>Размеры: ШхВхГ</p> <p>Ширина не более 460мм не меньше 459 мм</p> <p>Высота не более 965 мм не меньше 964 мм</p> <p>Глубина не более 775 мм не меньше 774 мм</p>	
3	Требования к условиям эксплуатации	Электропитание 220 В		
4	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	DDP пункт назначения		
5	Срок поставки МИ и место дислокации	90 дней с момента подписания уполномоченными лицами сторон Договора		
6	Условия	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.		

	гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	<p>Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.</p> <p>Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; <p>- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);</p> <p>- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.</p>
7	Требования к сопутствующим услугам	<p>Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров).</p> <p>Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.</p>

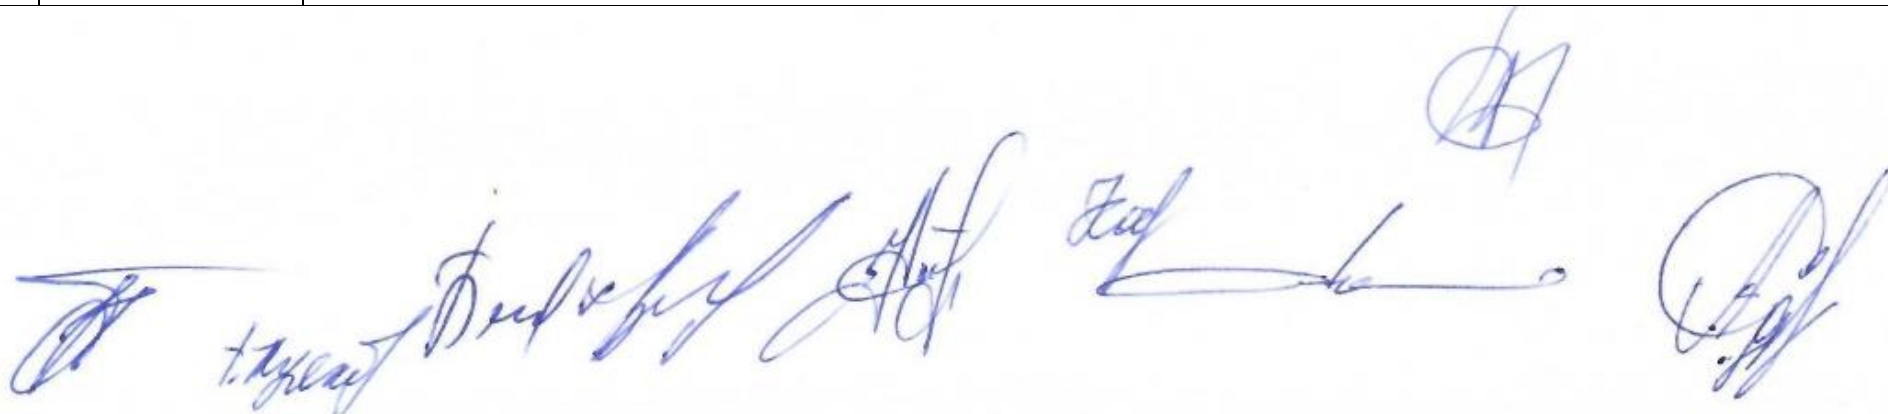

Handwritten signatures in blue ink, likely representing the parties involved in the agreement, including the supplier and the client.